Stand 13.02.2019

OSSENBERG
Qualität fest im Griff

Gebrauchsanweisung für PROTEKTOR den Rollatorschirm
Artikel 4090 / 4092 / 4093

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Anwendung genau durch, befolgen Sie die Hinweise und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig auf!

Einsatzbereich / Zweckbestimmung

PROTEKTOR der Rollatorschirm bietet einen optimalen Schutz vor Regen und Sonne, während der Rollator beidhändig geführt werden kann. Einsetzbar für alle 4-rädrigen Rollatoren, auch für Rollstühle. Nicht geeignet für Delta-Gehräder.

Technische Daten:

Gewicht: 1 kg
Durchmesser in geöffnetem Zustand: 105 cm

Artikel-Nr.: 4090	Farbe: Sand
Artikel-Nr.: 4092	Farbe: Anthrazit
Artikel-Nr.: 4093	Farbe: Rot

Sicherheitshinweise:

Diese Bedienungsanleitung ist vor dem Gebrauch zu lesen und zu beachten.

Vor jeder Anwendung ist der feste Sitz des Rollatorschirms zu überprüfen. Bitte beachten Sie, dass der Rollatorschirm die Bremsfunktion des Rollators nicht beeinträchtigt. Auch Beleuchtung, Klingel und Stockhalter dürfen nicht beeinträchtigt werden.

Vor der ersten Benutzung bei Regen und im Straßenverkehr machen Sie sich bitte mit dem Mechanismus des Rollatorschirmes vertraut und achten Sie bitte auf Umfang und Höhe des montierten Rollatorschirmes.

Beim Betätigen der Automatik-Öffnung bitte den Schirm vom Körper entfernt halten und auf umstehende Personen achten, um Verletzungen zu vermeiden. Beachten Sie bitte auch den Platzbedarf des Rollatorschirmes beim Öffnen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Beim Schließen des Rollatorschirmes und beim Betätigen der Rastgelenke bitte ein Fingerklemmen vermeiden. Im geschlossenen Zustand bitte den Schirm eindrehen und die Klettverschlussbänder schließen.

Beim Abstellen des Rollators bitte immer den Rollatorschirm schließen, den Schirm eindrehen und die Klettbänder schließen.

Bei Benutzung im Straßenverkehr achten Sie bitte stets auf ein freies Sichtfeld. Bitte beachten Sie den Umfang und die Höhe des geöffneten Rollatorschirmes.

Bei starkem Wind empfehlen wir, den Rollatorschirm zu schließen.

Der Rollatorschirm ist nicht zum Tragen und Schieben des Rollators bestimmt.

Verpackungsinhalt

1. Rollatorschirm mit Rastgelenken
2. Befestigungseinheit, vormontiert für Rohr Ø 22 mm
3. Befestigungsschellen für Rohr Ø 18 / 20 / 25 mm
4. Schraubenset (2 St.) M6 x 45 mm
5. Schraubenset (2 St.) M6 x 75 mm
6. Inbusschlüssel



Montage

- Die Befestigungseinheit des Rollatorschirmes ist bereits passend für die Befestigung am Standard-Rollator mit 22 mm Rundrohr vormontiert (Abb.1).
- Bitte befestigen Sie die Befestigungseinheit am höhenverstellbaren Schiebegriff-Rohr des Rollators mit Hilfe des Inbusschlüssels. Das Feststellhandrad zeigt nach vorn in Fahrtrichtung (Abb. 2).
- Für die Befestigung am 18/20/25 mm Rundrohr bitte die entsprechenden Befestigungsschellen austauschen.
- Für die Befestigung am Ovalrohr wählen Sie bitte einen passenden Satz der beiliegenden Befestigungsschellen und Schrauben aus, sodass ein fester Sitz gewährleistet ist (Abb. 3+4).

Zur Befestigung am TORO „TROJA“ verwenden Sie bitte je eine 22+18 mm Befestigungsschelle (Abb. 7).

Abb. 1


Abb. 2


Abb. 3


Abb. 4


Abb. 5

Das Rohrende des Rollatorschirmes bitte in die Befestigungsschelle setzen und das Feststell-Handrad festdrehen. Der Rollatorschirm ist nun montiert und kann durch einfache Betätigung der Druckmechanismen der Rastgelenke ausgeklappt werden (Abb. 5+6).

Abb. 6

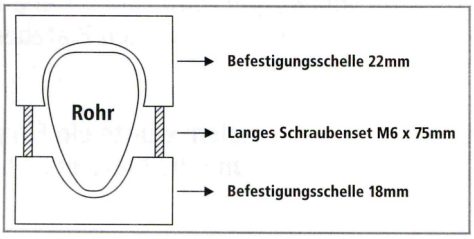

Abb. 7

Bedienung

Um Öffnen des am Rollator bereits montierten Rollatorschirmes bitte die Klettverschlüsse lösen (1) und die Automatik-Öffnung durch Knopfdruck betätigen (2). Achtung, der Schirm schwenkt aus.

Durch den einfachen Druckmechanismus am stabilen Rastgelenk (3) können Sie den Rollatorschirm in verschiedene Positionen bringen. Eine weitere Positionierung ist durch leichtes Lösen des Feststellrades (4) möglich. Bitte anschließend wieder festziehen.

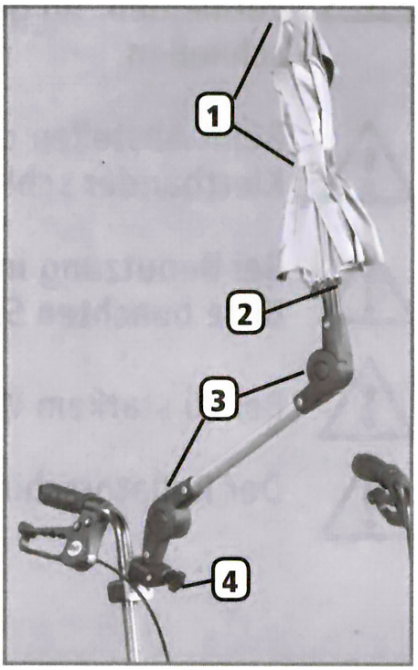

Ossenberg GmbH
Produktion und Vertrieb
orthopädischer Hilfsmittel

Kanalstraße 79
48432 Rheine
DEUTSCHLAND

Telefon +49 (0) 59 71 – 9 80 46 0
Fax +49 (0) 59 71 – 9 80 46 16

Internet www.ossenberg.com
E-Mail info@ossenberg.com

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Produkte gemäß den Richtlinien des Medizinproduktegesetzes.
Des Weiteren sind wir nach DIN EN ISO 13485 zertifiziert.

ZDH ZERT
DIN EN ISO 13485
REG.-NR. MQ1 0115318

CE